米国アキュトーム社製

The Next Generation in Handheld Tonometry

ワンタッチ操作で測定できます。

正確なIOPを測定＆キャリブレーション不要です。

人間工学デザイン設計で、角膜の視野が容易に確認できます。

大きなLCD画面で最大9回の測定値を保存できます。

Accu Pen

AccuPen 使用方法

＊別冊の取扱説明書を必ずよく読んでからお使いください。

①各構成
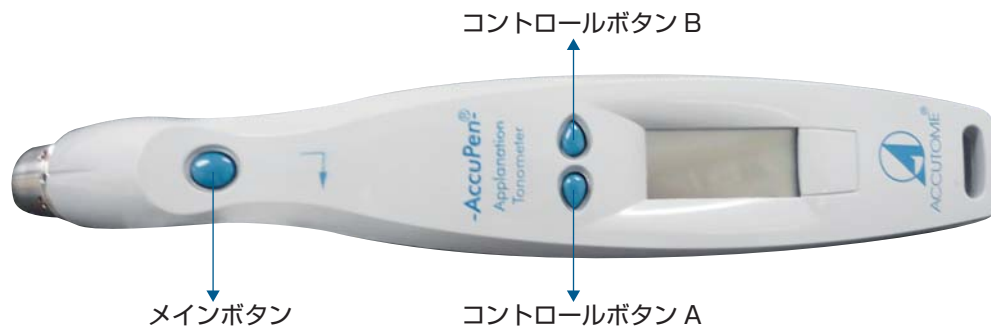
②電源を入れる

メインボタンを押しピーと音が鳴るまで待ちます。
画面に00と表示されます。

図1

③準備する（カバーはディスポーザブル製品です。再利用はできません。）

先端チップにカバー（単回使用）を取り付けます。
メインボタンを押すと、ピーピーと２回音が鳴ります。
00の横に回転する線が出たら測定できます。（図１）

④測定する

数回患者さんの目にプローブを当てます。
正しく測定されている時はピッと音が鳴ります。
測定が終了すると、ピーと音が鳴ります。
連続で９回まで測定できます。
＊９回または、一定時間が経過すると３回ビープ音が鳴り測定できません。
再度測定する時は、メインボタンを押して下さい。

⑤記録する

測定が終了すると画面の上下に数値が出ます。（図２）
上の数値・・・最後に測定した実数値
下の数値・・・全ての平均値
コントロールボタンＡを押すと１つ前の記録が見れます。
コントロールボタンＢを押すと１つ後の記録が見れます。
＊２回目以降の平均値は全ての回数の平均値になります。
＊片眼が終了したら全ての数値をリセットをして使用して下さい。

図２

⑥リセットする

全ての数値をリセットする時は、コントロールボタン両方を３秒間押します。
選択してリセットする時は、消去したい画面にしてどちらかのコントロールボタンを３秒間押します。

⑦電源を切る

自動的に電源は切れますので、操作は必要ありません。
大体60秒位かかります。

⑧電池交換をする

本体裏にある電池カバーをマイナスドライバーで外します。
リチウムバッテリーを交換します。（市販にて購入できます。）
バッテリーは約９～11か月持続します。（使用状況にて異なります。）

仕様

品名	AccuPen（アキュペン）
カタログ番号	24-3000
寸法	184mm×32mm×32mm
重量	95g
測定範囲	5～60mmHg（1mmHg刻み）
電源	リチウムバッテリー　3.6V

別売り品

AX9950	アキュチップ　50個/1箱

認証番号：Z21ADBZX00048000

製造元

Accutome Inc U.S.A

製造販売業者

株式会社 ホワイトメディカル
〒116-0014　東京都荒川区東日暮里 5-48-2　第一ビル
TEL. 03(3802)0655　FAX. 03(3802)0688
URL ▶ http://www.whitemedical.co.jp
E-mail:white1@sepia.ocn.ne.jp